


ZV2

Implantes de conexión cónica



ZV2

Implantes de conexión cónica



Información importante

Lea atentamente antes de usar productos Ziacom®

Información general

Este documento contiene información básica para el uso de los sistemas de implantes dentales originales Ziacom®, en adelante «implantes dentales Ziacom®» o simplemente «productos Ziacom®». Esta documentación ha sido redactada como guía rápida de consulta para el facultativo responsable del tratamiento, en adelante «usuario», y no es por lo tanto una alternativa ni un sustituto de la formación especializada ni de la experiencia clínica profesional.

Los productos Ziacom® deben ser utilizados realizando una planificación adecuada del tratamiento y siguiendo rigurosamente los protocolos quirúrgicos y protésicos establecidos por el fabricante. Lea atentamente los protocolos quirúrgicos y protésicos específicos de cada producto, así como las instrucciones de uso y mantenimiento, antes de utilizar un producto Ziacom®. Puede consultarlos también en nuestra web www.ziacom.com o solicitarlos a su distribuidor oficial autorizado Ziacom® más próximo.

Información sobre responsabilidad, seguridad y garantía.

Las indicaciones de uso y manipulación de los productos Ziacom® se basan en la bibliografía internacional publicada, los estándares clínicos actuales y nuestra experiencia, por lo que deben ser entendidas como información general indicativa. La manipulación y uso de los productos Ziacom®, al estar fuera del control de Ziacom Medical SL, son responsabilidad única del usuario. Ziacom Medical SL, sus filiales y/o sus distribuidores oficiales autorizados declinan toda responsabilidad, expresa o implícita, total o parcial, por los posibles daños o perjuicios ocasionados por la mala manipulación del producto o por cualquier otro hecho no contemplado en sus protocolos y manuales para el correcto uso de sus productos.

El usuario del producto debe asegurarse de que el producto Ziacom® empleado es adecuado para el procedimiento y finalidad prevista. Ni estas instrucciones de uso ni los protocolos de trabajo o manipulación de los productos eximen al usuario de esta obligación. El uso, manipulación y aplicación clínica de los productos Ziacom® debe realizarse por personal profesional cualificado y con la titulación necesaria según la legislación vigente de cada país.

El uso, manipulación y/o aplicación, de forma total o parcial, en cualquiera de sus fases de realización de los productos Ziacom® por personal no cualificado o sin la necesaria titulación para ello anula automáticamente cualquier tipo de garantía y puede ocasionar graves daños a la salud del paciente.

Los productos Ziacom® forman parte de una sistemática propia, con características de diseño y protocolos de trabajo propios, que incluyen los implantes dentales, aditamentos o componentes de prótesis y el instrumental quirúrgico o protésico. El uso de productos Ziacom® en combinación con elementos o componentes de otros fabricantes puede producir un fracaso del tratamiento, provocar daños en los tejidos, provocar daños a las estructuras óseas, resultados estéticos no adecuados y daños graves a la salud del paciente. Por este motivo, sólo deben utilizarse productos originales Ziacom®.

El profesional clínico, encargado del tratamiento, es el único responsable de velar por el uso de productos originales Ziacom® y usarlos conforme a las instrucciones de uso y protocolos de manipulación correspondientes durante todo el proceso del tratamiento implantológico. El uso de componentes, instrumental o cualquier otro producto no original Ziacom® que se use solo o en combinación con cualquiera de los productos originales Ziacom® anulará automáticamente la garantía de los productos originales Ziacom®.

Consulte el Programa de Garantía Ziacom Medical SL (disponible en la web o contactando con Ziacom Medical SL, sus filiales o distribuidores autorizados).

Advertencia. No todos los productos Ziacom® están disponibles en todos los países. Consulte su disponibilidad.

La marca Ziacom® y otros nombres de productos o servicios, al igual que sus logotipos, mencionados en esta documentación o en la página web www.ziacom.com, son marcas registradas de Ziacom Medical SL.

Ziacom Medical SL se reserva el derecho a modificar, cambiar y eliminar cualquiera de los productos, precios o especificaciones técnicas referenciadas en su página web o en cualquiera de sus documentos sin previo aviso. Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o publicación total o parcial de esta documentación, en cualquier medio o formato, sin la correspondiente autorización por escrito de Ziacom Medical SL.





Índice

La Compañía	06
Together for health	06
Calidad Ziacom®	06
Titanio Zitium®	06
Apuesta por la innovación y la formación	07
Ziacom® en el mundo	07
- Sede central	07
- Filiales	07

ZV2 Implantes de conexión cónica

Implante ZV2	10
Características	10
Diámetros y longitudes	11
Tratamientos de superficie	12
- Superficie Titansure	12
Presentación del producto	14
Referencias ZV2	15
Recomendaciones de uso	16
Cómo consultar este catálogo	17
Ficha de producto	17
Simbología	17
Aditamentos Rehabilitaciones directas a implante	20
Aditamentos Rehabilitaciones con transepiteliales	28
Instrumental quirúrgico	38
Instrumental protésico	44
Protocolo cirúrgico simplificado	48
Limpieza, desinfección y esterilización	54

Together for health

En Ziacom® llevamos más de 20 años trabajando por la **salud bucodental** y el bienestar de pacientes en todo el mundo a través del **diseño y fabricación de soluciones innovadoras** en implantes dentales, componentes protésicos, instrumental quirúrgico y biomateriales de máxima calidad.

Fundada en el año 2004 con **capital 100% español**, la empresa inició su actividad como fabricante de implantes y aditamentos implantológicos para varias firmas del mercado europeo, lanzando los primeros **sistemas propios de implantes** en el 2006.

En el 2015 Ziacom® inició su **estrategia de diversificación** con el desarrollo de **nuevas líneas de negocio** y familias de producto y el lanzamiento de un **nuevo portfolio**, lo que llevó a la compañía a alcanzar, en el 2016, el **15% de la cuota de mercado español** con más de 230.000 implantes vendidos.

En 2022 la empresa ha iniciado un **ambicioso proyecto de crecimiento** que incluye nuevos objetivos de **expansión internacional**, ampliación y **diversificación** de la cartera de **productos y servicios** y el cambio de la identidad corporativa.

Calidad Ziacom®

El compromiso con la **calidad y la innovación** forma parte de los valores y la esencia de Ziacom® desde sus inicios.

Por ello, aplicamos la tecnología más avanzada en **todas las fases del ciclo de producción** de nuestros productos, desde el **diseño y fabricación** hasta los procesos de **verificación, limpieza y envasado**. Además, para la fabricación de todos nuestros productos empleamos únicamente **materias primas de alta calidad** y aplicamos **estrictos controles en los procesos** de selección de nuestros principales proveedores.

Ziacom Medical SL tiene la **licencia de fabricante de productos sanitarios** y la **autorización de comercialización** por la AEMPS 6425-PS (Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario) y nuestro **sistema**

de gestión de calidad está certificado conforme a los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 13485:2018 cumpliendo además con los requisitos de GMP 21 CFR 820.



Gracias al esfuerzo constante por ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad, todos nuestros implantes cuentan con una **garantía de por vida**.


Consulte las Condiciones Generales de Acceso a la Garantía para los productos Ziacom®.

Titanio Zitium®

Los implantes **ZV2** de Ziacom® están fabricados en **titanio grado 4 de extra alta tensión Zitium®** que les confiere una **mejora sustancial en su límite elástico y en sus propiedades mecánicas**.

Gracias al titanio **Zitium®** nuestros implantes mantienen la conformidad con los requisitos de las normas ASTM F67 e ISO 5832-3 y certificados conforme a los requisitos de la directiva médica 93/42/CEE y su modificación 2007/47/CE por el organismo notificado 0051.

Propiedades titanio Zitium®



FDA Approved*

*Consultar modelos aprobados

Los implantes Ziacom® se esterilizan mediante irradiación con Rayos Beta a 25 kGy, salvo los implantes de ortodoncia DSQ que se comercializan **no estériles**.

IMPORTANTE

Todos los productos (excepto los implantes dentales) recogidos en este catálogo de Ziacom® se comercializan no estériles y deben ser esterilizados antes de su uso.



Apuesta por la innovación y la formación

Con el objetivo de ofrecer siempre las mejores soluciones para el **bienestar de cada paciente**, y gracias a la experiencia y dedicación de **profesionales altamente cualificados** y a un **innovador Centro Tecnológico**, nuestro equipo de I+D+i trabaja a diario en un proceso constante de **investigación e innovación** para la **mejora continua** de nuestros productos y el desarrollo de **nuevas soluciones** que respondan a las demandas y necesidades de pacientes y profesionales.

Mantenemos, además, una clara apuesta por la **investigación** y la **formación constante** como medio para dotar de **soporte científico al sector** y creemos firmemente en la formación de los **jóvenes profesionales** como la mejor garantía para el **progreso de la odontología**.

Por ello, colaboramos con **centros de formación, universidades y sociedades científicas** para la creación de un entorno didáctico práctico y especializado que potencie sus conocimientos, sus capacidades y su crecimiento profesional.

En nuestra apuesta por la formación y el **desarrollo de los profesionales** del sector, en nuestras instalaciones contamos con **espacios específicos para la formación y prácticas hands-on**, equipamiento formativo de **última tecnología**, así como un **showroom físico y virtual** donde conocer de primera mano todas nuestras soluciones dentales.

Ziacom® en el mundo

Comprometidos en llevar la salud bucodental a pacientes en todo el mundo, contamos con un sólido **plan de crecimiento y expansión internacional** con el que incrementar la **presencia internacional** de la compañía en aquellas **áreas ya consolidadas**, así como incorporar otras de **nuevo crecimiento**.

Para ello, ofrecemos a nuestros **partners internacionales** una relación de **confianza y colaboración**, adaptándonos a sus **necesidades locales** con soluciones a la medida de cada mercado.

En nuestro afán por cumplir con los requisitos de **calidad, normativos y legales específicos de cada país**, tanto para los procesos de registro como de distribución de nuestros productos, contamos con las **certificaciones específicas** de cada uno de los territorios donde actuamos.

Sede central

Ziacom Medical SL

Madrid - ESPAÑA
Calle Búhos, 2 - 28320 Pinto
Tel: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Filiales

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5º B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

Miami - EEUU
333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1(786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com

Puede consultar el listado actualizado de distribuidores Ziacom® en www.ziacom.com o enviando un email a export@ziacom.com






ZVZ

Zv2



Implantes de conexión cónica



Características

CONEXIÓN

- Conexión cónica cono morse de 11° con doble hexágono interno.
- Sellado cónico: sin infiltración.
- Fricción cónica: sin microfiltraciones.
- Plataforma RP y WP.
- Platform Switch: modelado de tejidos blandos y conformación del perfil de emergencia.

ZONA CORTICAL


- Hombro diseñado para posición a nivel cresta.
- Núcleo levemente cónico en zona coronal: compresión cortical óptima.
- Espira en reducción hasta plataforma.
- Bisel de 0,20 mm (a excepción del implante de diámetro 3,40 mm cuyo bisel es de 0,15 mm).

CUERPO


- Espiras activas que favorecen la estabilidad durante la inserción con paso de rosca 0,80 mm.
- Morfología cilíndrica optimizada: alta estabilidad primaria.
- Ápice atraumático: no lesivo con estructuras anatómicas.

DISEÑO CILÍNDRICO
















- Versátil, apto para todas las localizaciones.
- Disponible en diámetro estrecho 3,40 mm.
- Morfología permite compatibilidad quirúrgica.



Medidas de la zona coronal del implante



Diámetros y longitudes

Ø DIÁMETRO	Ø PLATAFORMA	LONGITUD (L)				
		6	8	10	12	14
 RP 3,40	2,85					
 RP 4,10						
 WP 4,80	3,85					

Cotas en mm.

Tratamientos de superficie

■ Superficie Titansure

Las superficies con tratamiento superficial han demostrado una mejora de la osteointegración al incrementar el contacto hueso-implante. Esto se debe en parte a la composición química del implante y también a sus características topográficas.


Con su superficie **Titansure**, Ziacom Medical logra una topografía superficial libre de contaminantes y una macro y microporosidad con valores promedios óptimos cuyas características son claves para lograr una correcta y rápida osteointegración, lo que le confiere una muy buena fiabilidad y una gran predictibilidad.

■ ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE TITANSURE

La superficie **Titansure** es de tipo S.L.A. y se obtiene por sustracción mediante arenado con corindón blanco y doble grabado de ácido fluorhídrico y combinación de ácido sulfúrico y fosfórico.


Análisis morfológico de la superficie

Utilizando un microscopio electrónico de barrido (FEI TENEO, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EE. UU.), se pudo observar la superficie rugosa y porosa con numerosas cavidades con bordes delgados y afilados.



Análisis elemental de la superficie

Utilizando un espectrómetro de rayos X de dispersión de energía (Octane Super, Edax-Ametek, Mahwah, NJ, EE. UU.), se analizó la composición química de la superficie.



Compositional analysis of implant surface

ELEMENT	WEIGHT (%)
C K	9.32 (10.23)
Al K	-
Ti K	89.53 (11.77)

No aluminum was detected

Los resultados del análisis se expresan como media y desviación estándar del porcentaje de contenido de masa (WEIGHT (%)).


Análisis de la rugosidad de la superficie

El estudio de rugosidad se realizó con el microscopio confocal-interferométrico Sensofar S NEOX (Sensofar Medical, Terrasa, España) y el software SensoMAP Premium 7.4. Los parámetros cuantitativos de rugosidad utilizados fueron rugosidad media del perfil (Ra), la desviación media del perfil de rugosidad (Rq), la altura máxima de pico del perfil de rugosidad (Rp), y la profundidad máxima de valle del perfil de rugosidad (Rv).

Ra (μm) (SD)	Rq (μm) (SD)	Rp (μm) (SD)	Rv (μm) (SD)
0.82 (0.10)	0.97 (0.08)	1.84 (0.04)	2.21 (0.01)

También se registraron la rugosidad tridimensional de la superficie (Sa), la altura media tridimensional (Sq), la altura máxima del pico tridimensional (Sp), y profundidad máxima del valle del área seleccionada (Sv).

Sa (μm) (SD)	Sq (μm) (SD)	Sp (μm) (SD)	Sv (μm) (SD)
0.76 (0.01)	0.97 (0.01)	4.20 (0.12)	4.62 (0.20)



Los datos han sido extraídos de la siguiente publicación:

Rizo-Gorrita, M.; Fernandez-Asian, I.; Garcia-de-Frenza, A.; Vazquez-Pachon, C.; Serrera-Figallo, M.; Torres-Lagares, D.; Gutierrez-Perez, J. Influence of Three Dental Implant Surfaces on Cell Viability and Bone Behavior. An In Vitro and a Histometric Study in a Rabbit Model. Appl. Sci. 2020, 10(14), 4790

■ ÓPTIMA OSTEOINTEGRACIÓN

La superficie **Titansure** se caracteriza por una estructura superficial tridimensional con picos altos y valles amplios, lo cual es sabido muy eficaz para promover la cascada de la coagulación y la liberación de factores de crecimiento a través de la activación plaquetaria [Kim, H.; Choi, S.H.; Ryu, J.J.; Koh, S.Y.; Park, J.H.; Lee, I.S. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed. Mater. 2008, 3, 025011].

Este tipo de superficie podría tener un efecto osteogénico gracias a sus diferentes características topográficas a nivel micrométrico y nanométrico, muy similar en morfología a las cavidades de reabsorción osteoclástica en el hueso [Le Guehennec, L.; Goyenvalle, E.; Lopez-Heredia, M.A.; Weiss, P.; Amouriq, Y.; Layrolle, P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in the femoral epiphyses of rabbits. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1103–1110].

Para más información sobre el tratamiento de superficie consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Implante Zv2

Presentación de producto

■ Envasado en bote

Disponible para implantes con superficie **Titansure**. El bote se presenta sellado para la óptima conservación de las propiedades del implante. Incluye etiqueta identificativa del producto para su correcta trazabilidad.

Titansure



IMPORTANTE

No abra el envase estéril hasta el momento de la colocación del implante.

■ Etiqueta identificativa externa

Los implantes Ziacom® se presentan en una caja de cartón sellada que incluye la etiqueta identificativa del producto con la descripción de sus principales características.

CE 0051	Ziacom®	Implante Dental ES	ZIACOM MEDICAL, S.L. Calle Balmes, 2 28030 Pinto - Madrid España Teléfono: +34 91 723 33 06 Fax: +34 91 723 33 06 Email: info@ziacom.com
Rx Only	ZV24110	Dental Implant EN	
RP	Z0000000	Zahnimplantat DE	
1 Unid	Ø4,10X10mm	Implant Dentaire FR	
ZV2®	VPres®	Implanto Dentale IT	
4,10X10mm	www.ziacom.com	Implante Dentário PT	
STERILE R	(01)08435481243677(17)000000(11)000000(10)Z0000000	UDI	QR Code
TT ZV2®	0000-00-00	0000-00-00	

Explicación de la simbología utilizada

- | | | | |
|-----------|--|---------|---|
| CE | MDD certificado CE y organismo notificado | ⊗ | No utilizar si el embalaje está dañado |
| MD | Nombre del producto sanitario | ⊗ | Producto no reutilizable |
| LOT | Número de lote del producto | 📖 | Consultar las instrucciones de uso |
| 🌐 | Página web para información de los pacientes | 🕒 | Fecha de caducidad del producto |
| UDI | Identificador único de producto | 🏭 | Fecha de fabricación |
| STERILE R | Esterilización mediante radiación | 🏭 | Fabricante del producto |
| 🌡️ | Limitación de temperatura | TT | Tratamiento de superficie Titansure. |
| ⚠️ | Cuidado, consulte documentación adjunta | TTA | Tratamiento de superficie Titansure Active. |
| ♻️ | No reesterilizar | Rx Only | Sólo por prescripción |

Consulte todos los detalles de la presentación del producto y sus instrucciones de uso (IFU) en www.ziacom.com/ifus o a través del código QR de la caja.



Ziacom® No Mount

El implante ZV2 se presenta en el vial portaimplante Ziacom® No Mount (sin transportador) donde un vial plástico aloja en posición vertical el implante entre una placa inferior y una arandela superior en ambos casos de titanio, proporcionándole estabilidad sin movimientos al tiempo que evita contactos.

Este envasado permite que la presión para extraer el implante del vial y llevarlo al lecho quirúrgico con facilidad y seguridad se realice directamente sobre su conexión. De esta forma, el implante Ziacom® No Mount elimina el riesgo de reducción de la estabilidad primaria asociado a la sobre instrumentación, evita la manipulación del implante en el proceso de desmontaje del Mount y además reduce la dificultad en la inserción del implante en sectores posteriores con apertura bucal reducida.



Referencias ZV2

IMPLANTE					
	Ø (mm)	Ø Núcleo (mm)	Longitud	Ref. Titansure	
ZV2	3,40	2,80	8,0	ZV23408	
			10,0	ZV23410	
			12,0	ZV23412	
			14,0	ZV23414	
4,10	3,40	6,0	ZV24106		
		8,0	ZV24108		
		10,0	ZV24110		
		12,0	ZV24112		
		14,0	ZV24114		
4,80	4,10	10,0	ZV24810		
		12,0	ZV24812		
		14,0	ZV24814		

Métrica



Métricas de 1,60 (RP) y 2,00 (WP)

Tornillo de cierre*





Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	5,10	GLYRT
	6,10	GLYWT

Anodizado RP WP



* Tornillo ya incluido en cada implante.

Plataforma



(1) Altura del cono interno (2) Diámetro de la plataforma de trabajo

Recomendaciones de uso

Toda tratamiento implantológico debe respetar la estabilidad bio-mecánica natural de la cavidad oral y permitir la emergencia natural de la corona dental a través del tejido blando. El implantólogo debe valorar la cantidad y calidad del hueso existente en la zona receptora del implante y considerar la necesidad de regeneración ósea previa o simultánea según el caso.

Ziacom® dispone de una amplia gama de implantes con los que cubrir todas las posibilidades restauradoras existentes. A través de los trapecios invertidos del odontograma expuesto se representan los diámetros y las plataformas de los implantes recomendados para cada posición dentaria.

Estas recomendaciones son válidas para la sustitución de dientes con rehabilitaciones unitarias, puentes, híbridas o sobredentaduras.

Recuerde mantener las distancias mínimas entre implantes adyacentes y entre implantes y piezas dentales para preservar papilas, la vascularización ósea y los perfiles naturales de emergencia.

La elección del implante adecuado para cada caso es responsabilidad exclusiva del implantólogo. Ziacom® recomienda tener en consideración las advertencias en base a las evidencias científicas recogidas en los catálogos de producto y en la página web.

■ ACLARACIONES SOBRE MEDIDAS Y TÉCNICAS DE FRESADO

- **TALLA DEL IMPLANTE:** identifica el diámetro y la longitud del implante.
- **CUERPO DEL IMPLANTE:** diámetro del núcleo del implante.
- **MEDIDA DE LA FRESA:** corresponde con el diámetro de la fresa.
- **TÉCNICA DE FRESADO:** hemos elaborado los diferentes protocolos de fresado para que le permitan abordar de manera esquematizada las diferentes situaciones que se generan al afrontar una cirugía con implantes.

Odontograma

Zv2


Diámetro del implante⁽¹⁾

A RP **B** RP **WP**
Ø3,40 mm Ø4,10 mm Ø4,80 mm

(1) Los diámetros están disponibles para las plataformas análogas

Diámetro coronal del implante

RP **WP**
Ø2,85 mm Ø3,85 mm

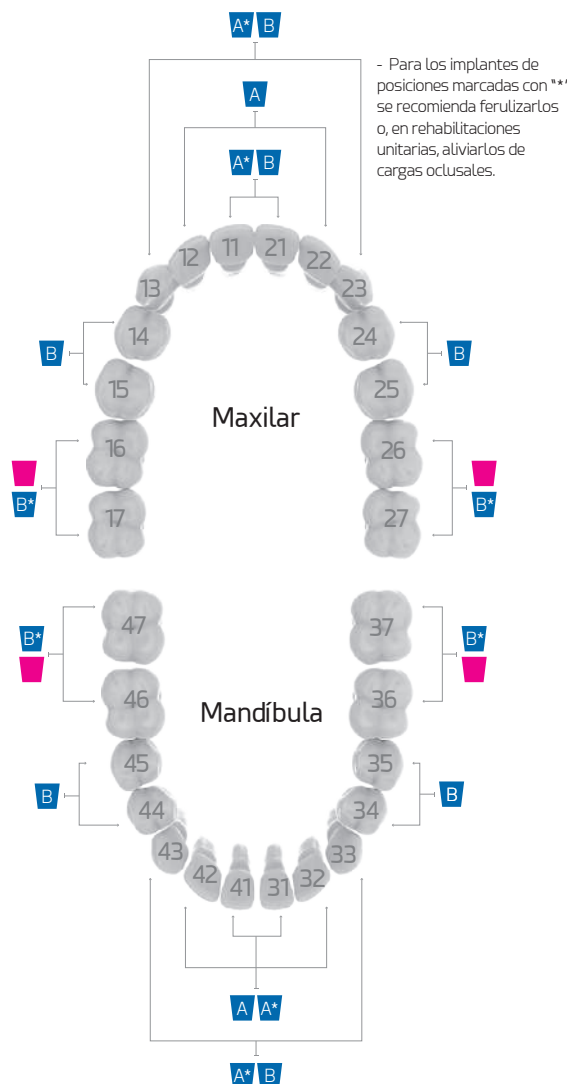


Para más información sobre la elección de la talla del implante consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Cómo consultar este catálogo

Ficha de producto

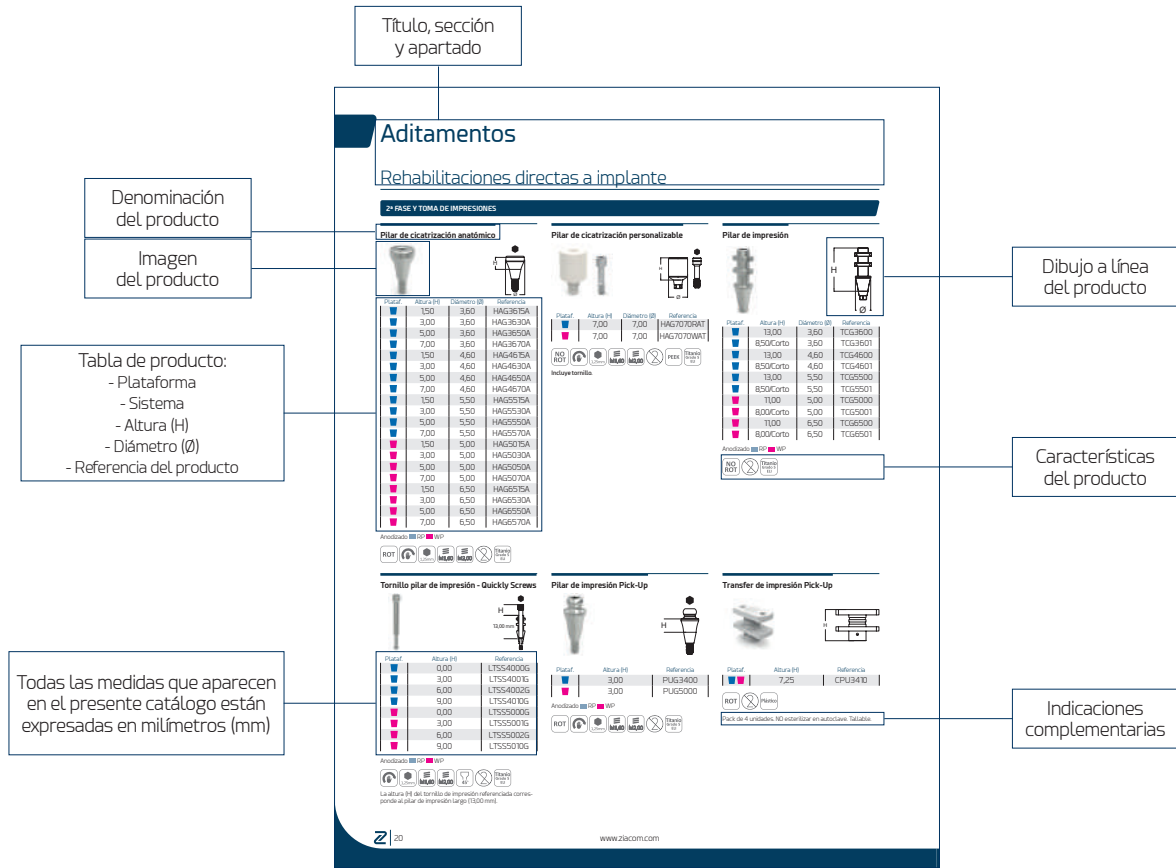

Simbología

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Elemento rotatorio		Conexión Tx30		Fabricado en Cromo-Cobalto + plástico calcinable
	Elemento no rotatorio		Métrica en milímetros		Fabricado en Cromo-Cobalto
	Usar con torque manual (consulte tabla pág. 35)		Apoyo del tornillo a 45°		Fabricado en PEEK
	Torque máximo de uso		Apoyo del tornillo a 90°		Fabricado en plástico calcinable
	Rango de torques de la carraca		Uso en rotación con CA		Fabricado en plástico
	Conexión Galaxy		Velocidad máxima de giro		Temperatura recomendada de esterilización
	Conexión del tornillo		Número de usos máximos		Producto no esterilizado
	Conexión Kirator		Producto de un sólo uso		Usar con irrigación abundante
	Conexión Basic		Fabricado en Titanio Grado 5 ELI (Extra Low Interstitials)		Angulación máxima
	Conexión XDrive		Fabricado en Acero inoxidable		



ZVZ

Aditamentos


Rehabilitaciones
directas a implante



Rehabilitaciones directas a implante

2ª FASE Y TOMA DE IMPRESIONES

Pilar de cicatrización anatómico




Plataf.	Altura (H)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,50	3,60	HAG3615A
■	3,00	3,60	HAG3630A
■	5,00	3,60	HAG3650A
■	7,00	3,60	HAG3670A
■	1,50	4,60	HAG4615A
■	3,00	4,60	HAG4630A
■	5,00	4,60	HAG4650A
■	7,00	4,60	HAG4670A
■	1,50	5,50	HAG5515A
■	3,00	5,50	HAG5530A
■	5,00	5,50	HAG5550A
■	7,00	5,50	HAG5570A
■	1,50	5,00	HAG5015A
■	3,00	5,00	HAG5030A
■	5,00	5,00	HAG5050A
■	7,00	5,00	HAG5070A
■	1,50	6,50	HAG6515A
■	3,00	6,50	HAG6530A
■	5,00	6,50	HAG6550A
■	7,00	6,50	HAG6570A

Anodizado ■ RP ■ WP



Pilar de cicatrización personalizable




Plataf.	Altura (H)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	7,00	7,00	HAG7070RAT
■	7,00	7,00	HAG7070WAT



Incluye tornillo.

Pilar de impresión




Plataf.	Altura (H)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	13,00	3,60	TCG3600
■	8,50/Corto	3,60	TCG3601
■	13,00	4,60	TCG4600
■	8,50/Corto	4,60	TCG4601
■	13,00	5,50	TCG5500
■	8,50/Corto	5,50	TCG5501
■	11,00	5,00	TCG5000
■	8,00/Corto	5,00	TCG5001
■	11,00	6,50	TCG6500
■	8,00/Corto	6,50	TCG6501

Anodizado ■ RP ■ WP



Tornillo pilar de impresión - Quickly Screws




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	0,00	LTSS4000G
■	3,00	LTSS4001G
■	6,00	LTSS4002G
■	9,00	LTSS4010G
■	0,00	LTSS5000G
■	3,00	LTSS5001G
■	6,00	LTSS5002G
■	9,00	LTSS5010G

Anodizado ■ RP ■ WP



La altura (H) del tornillo de impresión referenciada corresponde al pilar de impresión largo (13,00 mm).

Pilar de impresión Pick-Up




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	3,00	PUG3400
■	3,00	PUG5000

Anodizado ■ RP ■ WP



Transfer de impresión Pick-Up




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■	7,25	CPU3410



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Pilar de impresión Z2Plus Snap-On



Plataf.	Altura (H)	Longitud (L)	Referencia
■	3,00	9,50	Z2RPG10
■	3,00	9,50	Z2WPG10


Anodizado ■ RP ■ WP



IMPORTANTE

Para la fijación de este pilar de impresión utilice el tornillo de laboratorio.

Transfer de impresión Z2Plus Snap-On




Plataf.	Altura (H)	Referencia
■ ■	8,00	ZPU3400



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Análogo de Implante



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	12,00	IAG3400
■	12,00	IAG5000




Análogo de implante 3D

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	12,00	IAG3400D
■	12,00	IAG5000D



ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Tornillo clínico Kiran



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	8,20	DSG4010
■	10,40	DSG5010



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.

Tornillo de laboratorio




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	8,00	LBG4000
■	8,80	LBG5000



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Tornillo clínico Kiran Tx30



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
■	7,55	DSG4010TX
■	8,65	DSG5010TX



Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial. Uso solo con destornilladores Tx30.

Aditamentos

PROVISIONALES

Pilar provisional



Rotatorio

Plataf.	Altura (H)	Longitud (L)	Referencia
	1,50	10,50	RUGT3615
	3,00	12,00	RUGT3630
	1,50	10,50	RUGT5015
	3,00	12,00	RUGT5030

Anodizado RP WP



No rotatorio


Plataf.	Altura (H)	Longitud (L)	Referencia
	1,50	10,50	NUGT3615
	3,00	12,00	NUGT3630
	1,50	10,50	NUGT5015
	3,00	12,00	NUGT5030

Anodizado RP WP



Pilar provisional

Pilares para estética y carga inmediata



Rotatorio

Plataf.	Altura (H)	Longitud (L)	Referencia
	1,50	10,50	RUGP3615
	3,00	12,00	RUGP3630
	1,50	10,50	RUGP5015
	3,00	12,00	RUGP5030



No rotatorio

Plataf.	Altura (H)	Longitud (L)	Referencia
	1,50	10,50	NUGP3615
	3,00	12,00	NUGP3630
	1,50	10,50	NUGP5015
	3,00	12,00	NUGP5030




Incluye tornillo anodizado para todos los pilares provisionales.



ATORNILLADAS

■ UCLA BASE MECANIZADA

Pilar base mecanizada + Pilar calcinable



Rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	10,60	BRUG36
	10,60	BRUG50



Titanio Grado 5 ELI

No rotatorio

Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	10,60	BNUG36
	10,60	BNUG50



Titanio Grado 5 ELI

Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. DSG4010.

■ PILAR Tx30 ROTACIÓN VARIABLE

Pilar base mec. Tx30 + 2 P. Cal (15° y 20°)



Rotatorio

Plataf.	15° Longitud (L)	20° Longitud (L)	Referencia
	11,40	11,20	BRUG36TX
	11,40	11,20	BRUG50TX



No rotatorio

Plataf.	15° Longitud (L)	20° Longitud (L)	Referencia
	11,40	11,20	BNUG36TX
	11,40	11,20	BNUG50TX



Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. DSG4010TX para todos los pilares Tx30 Rotación variable.

Pilar base mec. Tx30 + 2 P. Cal (20° y 25°)



Rotatorio

Plataf.	20° Longitud (L)	25° Longitud (L)	Referencia
	11,20	11,00	BRUG36TX1
	11,20	11,00	BRUG50TX1



No rotatorio

Plataf.	20° Longitud (L)	25° Longitud (L)	Referencia
	11,20	11,00	BNUG36TX1
	11,20	11,00	BNUG50TX1



■ PILAR TX30 ROTACIÓN VARIABLE

El pilar Tx30 Rotación Variable está constituido por una base mecanizada de Cr-Co sobre la que se ajustan pilares calcinables angulados a 15°, 20° ó 25° y un tornillo clínico Kiran de conexión especial tipo Tx30.

La base de Cr-Co asegura un óptimo ajuste y sellado a la conexión del implante por su previa fabricación y las distintas angulaciones de los pilares calcinables permiten seleccionar el mejor posicionamiento para una adecuada emergencia del canal de acceso al tornillo de la restauración.




Surcos indicativos de las angulaciones de los calcinables

Aditamentos

CEMENTADAS

Pilar recto anatómico




Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Longitud (L)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,50/2,50	9,00	3,60	STG3615
■	3,00/4,00	10,50	3,60	STG3630
■	1,50/2,50	9,00	4,60	STG4615
■	3,00/4,00	10,50	4,60	STG4630
■	1,50/2,00	8,50	5,50	STG5515
■	3,00/3,50	10,00	5,50	STG5530
■	1,50/2,50	8,50	5,00	STG5015
■	3,00/4,00	10,50	5,00	STG5030
■	1,50/2,00	8,50	6,50	STG6515
■	3,00/3,50	10,00	6,50	STG6530

Anodizado ■ RP ■ WP



Pilar angulado 15° anatómico




Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Longitud (L)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,50/2,50	9,00	3,60	A1G3615
■	3,00/4,00	10,50	3,60	A2G3615
■	1,50/2,50	9,00	4,60	A1G4615
■	3,00/4,00	10,50	4,60	A2G4615
■	3,00/4,00	10,50	5,00	A2G5015

Anodizado ■ RP ■ WP



Pilar angulado 25° anatómico



Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Longitud (L)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,50/2,50	9,00	3,60	A1G3625
■	3,00/4,00	10,50	3,60	A2G3625
■	1,50/2,50	9,00	4,60	A1G4625
■	3,00/4,00	10,50	4,60	A2G4625

Anodizado ■ RP



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. DSG4010 para todos los pilares cementados.



Rehabilitaciones directas a implante

SOBREDENTADURA

Kirator



Pilar Kirator

Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,00	LOG4010
	2,00	LOG4020
	3,00	LOG4030
	4,00	LOG4040
	5,00	LOG4050
	6,00	LOG4060
	1,00	LOG5010
	2,00	LOG5020
	3,00	LOG5030
	4,00	LOG5040

Tratamiento superficial color dorado.

Llave de inserción Ref. LOSD01/LOSD02.



Incluye pilar Kirator con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Aditamentos relacionados

Transfer de impresión Kirator



Sistema	Altura (H)	Referencia
Kirator	6,50	TCRK3400



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tachable.

Análogo Kirator



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Kirator	13,00	IATORK01



Pack de procesado Kirator



Sistema	Referencia
Pack de procesado Kirator	TP8520

Pack de procesado Kirator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
Kirator	Suave/1,20Kg	TPK100
	Estándar/1,80Kg	TPK200
	Fuerte/2,70Kg	TPK300

Pack de 4 cofias retentivas plásticas Kirator.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 22° entre implantes.

Pack de procesado divergente Kirator



Sistema	Referencia
Pack de procesado Kirator	TP8520D

Pack de procesado divergente Kirator compuesto por: Cazoleta de titanio con cofia negra de rebasado, espaciador y tres cofias plásticas: morada, transparente y rosa.

Esterilizar la cofia metálica usando el autoclave. Las cofias plásticas y el disco deben desinfectarse en frío. Ver Instrucciones de Limpieza y Desinfección en la web de Ziacom®.

Sistema	Retención (Kg)	Referencia
Kirator	Suave/1,20Kg	TPK110
	Estándar/1,80Kg	TPK220
	Fuerte/2,70Kg	TPK330

Pack de 4 cofias retentivas plásticas Kirator - Divergentes.



NO esterilizable en autoclave, realizar desinfección en frío. Divergencia máxima de 44° entre implantes.

Secuencia demostrativa



Las referencias TPK110/TPK220/TPK330 del pack de procesado divergente Kirator están sujetas a disponibilidad.

Aditamentos

DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam a implante



Plataf.	Altura (H)	Longitud (L)	Referencia
■	3,00	8,00	FNSYG41T
■	3,00	8,00	FNSYG50T

Anodizado ■ RP ■ WP



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. LBG4000 para todos los scanbody ZiaCam a implante.

Consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca para más información sobre el uso de interfaces en rehabilitaciones con zirconio o sobre el uso de aditamentos en el "Manual de procedimientos protésicos".



Ti-Base ZiaCam



Rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,00/5,50	3,80	FRUG305
■	2,00/6,50	3,80	FRUG315
■	3,00/7,50	3,80	FRUG330
■	1,00/5,50	4,40	FRUG405
■	2,00/6,50	4,40	FRUG415
■	3,00/7,50	4,40	FRUG430
■	1,00/5,50	4,80	FRUG505
■	2,00/6,50	4,80	FRUG515
■	3,00/7,50	4,80	FRUG530
■	1,00/5,50	6,30	FRUG605
■	2,00/6,50	6,30	FRUG615
■	3,00/7,50	6,30	FRUG630



No rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,00/5,50	3,80	FNUG305
■	2,00/6,50	3,80	FNUG315
■	3,00/7,50	3,80	FNUG330
■	1,00/5,50	4,40	FNUG405
■	2,00/6,50	4,40	FNUG415
■	3,00/7,50	4,40	FNUG430
■	1,00/5,50	4,80	FNUG505
■	2,00/6,50	4,80	FNUG515
■	3,00/7,50	4,80	FNUG530
■	1,00/5,50	6,30	FNUG605
■	2,00/6,50	6,30	FNUG615
■	3,00/7,50	6,30	FNUG630



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. DSG4010.

Ti-Base ZiaCam Tx30



Rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,00/6,50	3,80	FRUG305TX
■	2,00/7,50	3,80	FRUG315TX
■	3,00/8,50	3,80	FRUG330TX (1)
■	1,00/6,50	4,40	FRUG405TX
■	2,00/7,50	4,40	FRUG415TX
■	3,00/8,50	4,40	FRUG430TX (1)
■	1,00/6,50	4,80	FRUG505TX
■	2,00/7,50	4,80	FRUG515TX
■	3,00/8,50	4,80	FRUG530TX (1)
■	1,00/6,50	6,30	FRUG605TX
■	2,00/7,50	6,30	FRUG615TX
■	3,00/8,50	6,30	FRUG630TX (1)



No rotatorio

Plataf.	Altura (Hg/Ht)	Diámetro (Ø)	Referencia
■	1,00/6,50	3,80	FNUG305TX
■	2,00/7,50	3,80	FNUG315TX
■	3,00/8,50	3,80	FNUG330TX (1)
■	1,00/6,50	4,40	FNUG405TX
■	2,00/7,50	4,40	FNUG415TX
■	3,00/8,50	4,40	FNUG430TX (1)
■	1,00/6,50	4,80	FNUG505TX
■	2,00/7,50	4,80	FNUG515TX
■	3,00/8,50	4,80	FNUG530TX (1)
■	1,00/6,50	6,30	FNUG605TX
■	2,00/7,50	6,30	FNUG615TX
■	3,00/8,50	6,30	FNUG630TX (1)



Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. DSG4010TX.

(1) Para alturas gingivales de 3,00 mm angulación máxima de 20° (el resto de alturas tienen una angulación máxima de 30°).

Aditamentos


Rehabilitaciones
con transepiteliales



Aditamentos

Rehabilitaciones con transepteliales


■ Basic | Secuencia demostrativa de uso

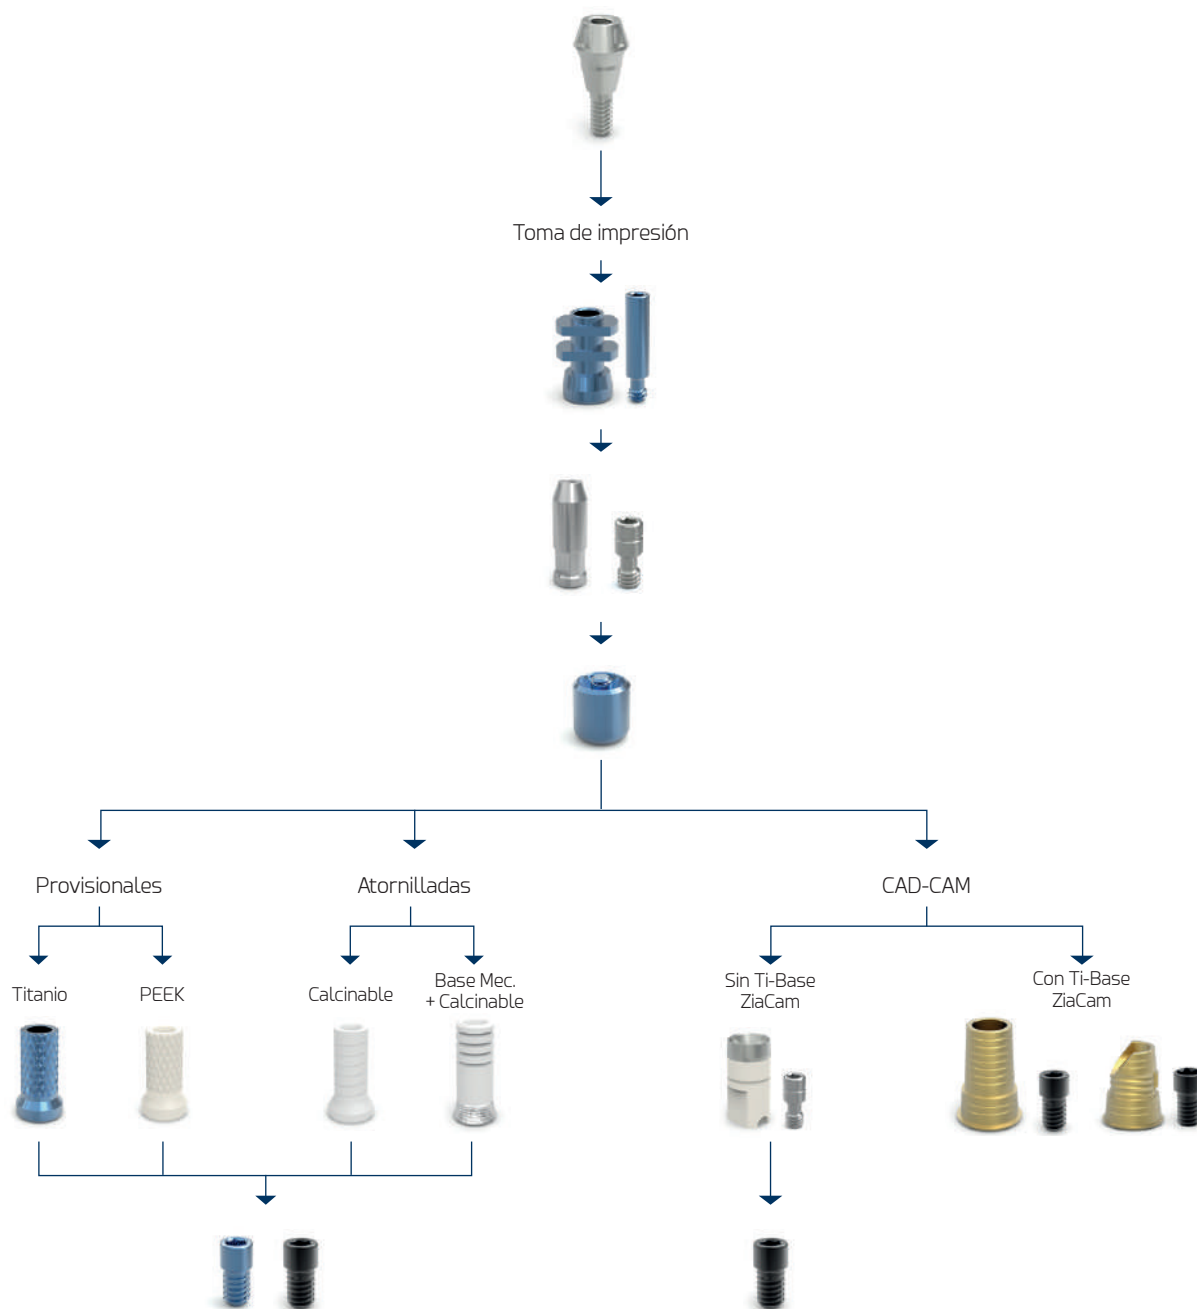

Para más información sobre el uso de los aditamentos consulte el "Manual de procedimientos protésicos" disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Pilar Basic



Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,50	BASICG415
	2,50	BASICG425
	3,50	BASICG435
	4,50	BASICG445
	5,50	BASICG455
	1,50	BASICG515
	2,50	BASICG525
	3,50	BASICG535
	4,50	BASICG545

Llave de inserción Ref. MABA100/MABA110




Incluye pilar Basic con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C). Angulación del cono de 18°. Angulación entre pilares de 36°.



Pilar Basic con aplicador

Pilar de cicatrización Basic



Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	5,00	BAHAEX34

Anodizado RP



Pilar de impresión Basic



Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	8,00	BATC134

Anodizado RP



No rotatorio


Sistema	Altura (H)	Referencia
Basic	8,00	BATN134

Anodizado RP



Incluye tornillo para todos los pilares de impresión Basic.

Análogo Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIAEX34



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIANEX34




Análogo Basic 3D

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	13,00	BAIAEX34D



Aditamentos

Tornillo clínico Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	4,30	BDSEI3400

Anodizado RP



Tornillo clínico Kiran Tx30 Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	4,10	BDSEI34TX



Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial.

Tornillo clínico Kiran Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	4,30	BDSEI3410



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.

Tornillo de laboratorio Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	5,50	BDSEI3401



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Pilar provisional Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,50	BARUT10

Anodizado RP



Pilar provisional Basic



Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,50	BARUP34



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,50	BANUP34



UCLA Basic



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	9,00	BARUEX34



Pilar base mec. Basic+ Pilar calcinable



Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	11,00	BBRU34



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	11,00	BBNU34



Scanbody ZiaCam a pilar Basic



Rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,70	FNSYB11T



No rotatorio

Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	8,70	FNSYB11NT



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. BDSEI3401 para todos los Scanbody ZiaCam a pilar Basic.

Ti-Base ZiaCam a Basic



Rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/6,70	BFRU341



No rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/6,70	BFNU341



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. BDSEI3410 para todos los Ti-Base ZiaCam a Basic.

Ti-Base ZiaCam Tx30 a Basic



Rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/5,70	BFRU341TX



No rotatorio

Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
Basic	0,30/5,70	BFNU341TX




Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. BDSEI34TX para todos los Ti-Base ZiaCam Tx30 a Basic.

Aditamentos

Rehabilitaciones con transepteliales

■ XDrive | Secuencia demostrativa de uso

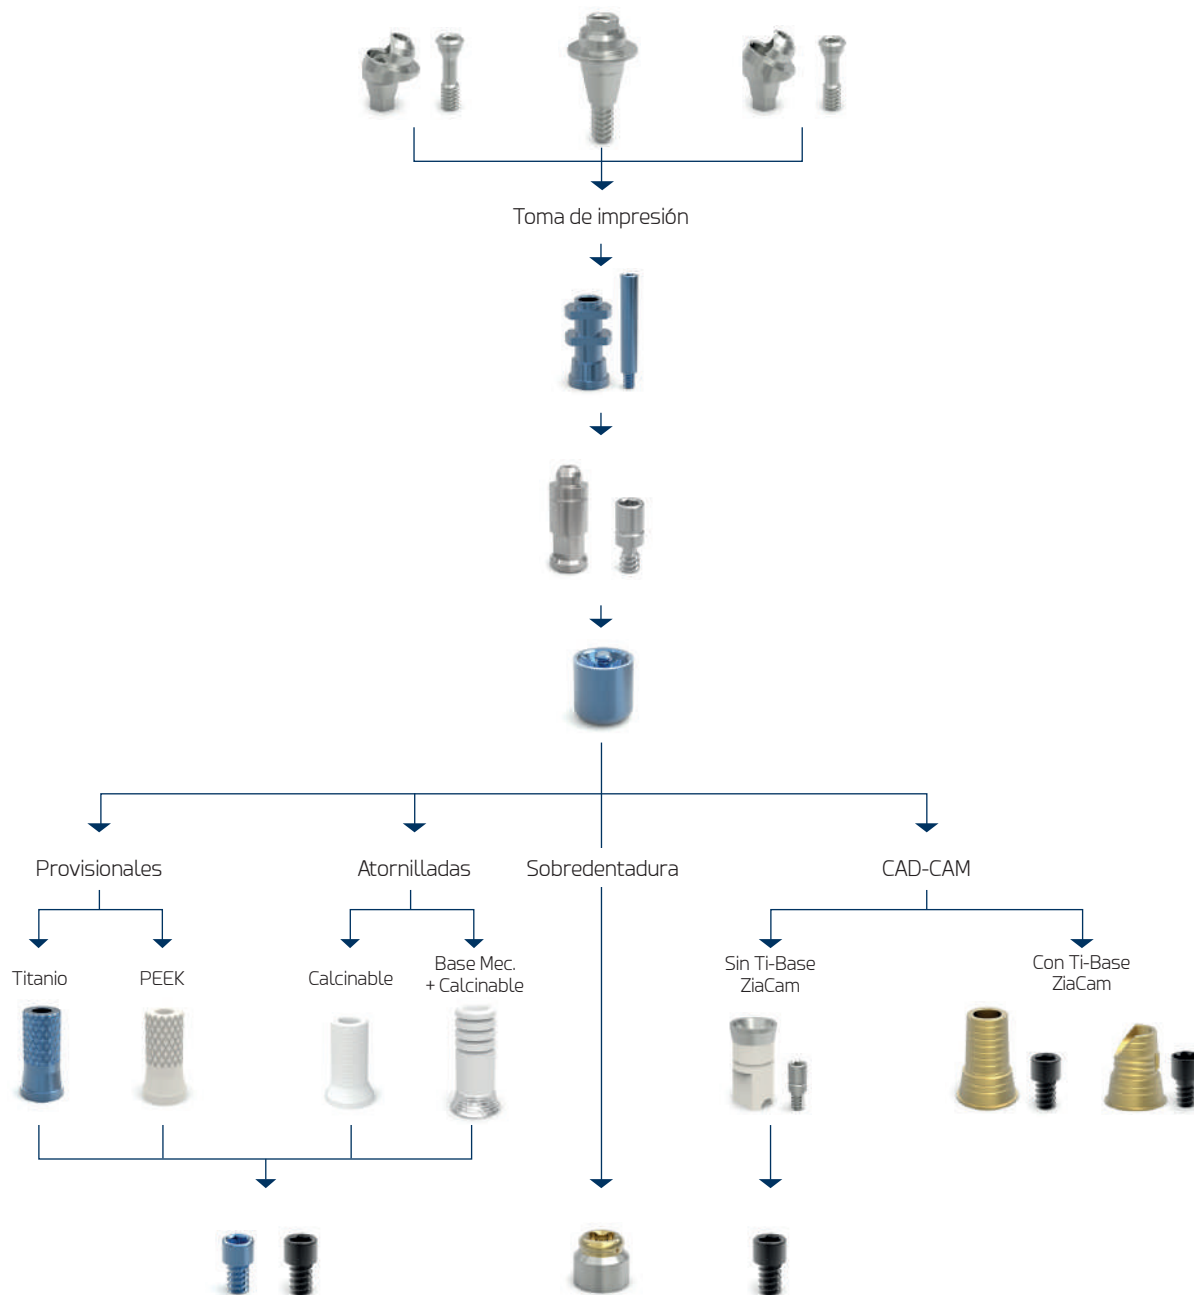

Para más información sobre el uso de los aditamentos consulte el "Manual de procedimientos protésicos" disponible en www.ziacom.com/biblioteca



Pilar recto XDrive



Plataf.	Altura (H)	Referencia
	1,50	XST10G15
	2,50	XST10G25
	3,50	XST10G35
	4,50	XST10G45
	5,50	XST10G55
	1,50	XST20G15
	2,50	XST20G25
	3,50	XST20G35

Llave de inserción Ref. MABA200/MABA210




Incluye pilar XDrive con aplicador plástico esterilizable de polioximetileno (Tecaform AH-POM-C).

Angulación del cono de 21°. Angulación entre pilares de 42°.



Pilar XDrive con aplicador

Pilar angulado 17° XDrive




Plataf.	Altura (H)	Referencia
	2,50	XA210G17
	3,50	XA310G17
	4,50	XA410G17
	5,50	XA510G17
	2,50	XA220G17
	3,50	XA320G17



Incluye posicionador metálico de acero inoxidable y tornillo para todos los pilares angulados XDrive.


Pilar angulado 30° XDrive



Plataf.	Altura (H)	Referencia
	3,50	XA310G30
	4,50	XA410G30
	5,50	XA510G30



Pilar de cicatrización XDrive




Sistema	Altura (H)	Referencia
XDrive	5,00	XH103400

Anodizado RP



Pilar de impresión XDrive




Sistema	Altura (H)	Referencia
XDrive	10,50	XT103411

Anodizado RP



Incluye tornillo.

Análogo XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	13,00	XIA103400




Análogo XDrive 3D

Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	13,00	XIA103400D



Aditamentos

Tornillo clínico XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	3,50	XDS103410

Anodizado ■ RP



Tornillo clínico Kiran XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	3,50	XDS103411



Tornillo especial Kiran con tratamiento superficial.

Tornillo de laboratorio XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	5,10	XLB103410



Tornillo NO apto para su uso como tornillo clínico definitivo.

Tornillo clínico Kiran Tx30 XDrive




Para Ti-Base ZiaCam o estructura metálica

Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	3,50	XDS3411TX



Tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial.

Pilar provisional XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	9,50	XST3410

Anodizado ■ RP



Pilar provisional XDrive




Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	9,50	XSP3410



XDrive

UCLA XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	8,00	XRU103400




Pilar base mec. XDrive + Pilar calcinable



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	11,00	XBRU34



Pilar Kirator XDrive




Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
XDrive	3,00/4,30	XL03400

Pilar Kirator con tratamiento superficial dorado.



Scanbody ZiaCam a pilar XDrive



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	8,70	FNSYX11T



Indicado para clínica.

Incluye tornillo Ref. XLB103410 para todos los Scanbody ZiaCam a pilar XDrive.

Ti-Base ZiaCam XDrive



Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
XDrive	0,15/6,70	XFRU341



Incluye tornillo especial Kiran con tratamiento superficial Ref. XDS103411.

Ti-Base ZiaCam Tx30 XDrive



Sistema	Altura (Hg/Ht)	Referencia
XDrive	0,15/5,70	XFRU341TX



Incluye tornillo especial Kiran Tx30 con tratamiento superficial Ref. XDS3411TX.

Tabla de torques para aditamentos

Elemento/Aditamento	Instrumento/Herramienta	Torque
Tornillos de cierre/Pilares de cicatrización	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos de pilares de impresión	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos de laboratorio	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Tornillos clínicos directos a implante	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Tornillos clínicos Kiran directos a implante	Destornillador Hex. 1,25 mm	30 Ncm
Pilares Basic/XDrive	Llaves de inserción: MABA100/MABA110/MABA200/MABA210	30 Ncm
Tornillos clínicos sobre Basic	Destornillador Hex. 1,25 mm	25 Ncm
Tornillos clínicos Kiran sobre Basic	Destornillador Hex. 1,25 mm	25 Ncm
Tornillos clínicos sobre XDrive	Destornillador Hex. 1,25 mm	20 Ncm
Tornillos clínicos Kiran sobre XDrive	Destornillador Hex. 1,25 mm	20 Ncm
Scanbody ZiaCam + Tornillo	Destornillador Hex. 1,25 mm	Manual
Pilares Kirator	Llaves de inserción: LOSD01/LOSD02	30 Ncm
Pilar/Tornillo Tx30 (Rotación Variable)	Destornillador Torx.Tx30	30 Ncm

ATENCIÓN

Sobrepasar el torque de apriete recomendado para tornillos y pilares pone en peligro la rehabilitación protésica y puede producir daños en la estructura del implante.



Para carga inmediata: NO apriete manualmente, fije con torque definitivo. Al usar destornillador o adaptador para contra ángulo (CA), no supere la velocidad máxima de 25 Rpm.



ZV2

Instrumental
quirúrgico



Instrumental quirúrgico

Caja de cirugía

Composiciones disponibles cajas ZV2

Plataf.	Contenido	Referencia
	Vacía	BOX920
	Básica manual/CA	BOX900SZV2
	Completa manual/CA	BOX901ZV2



Material: radel.

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.



Contenido de las cajas quirúrgicas

REF	Descripción	BOX900SZV2	ZV2
SID010	Fresa lanza. Ø2,00 mm	●	●
OSPD22Z	Fresa piloto. Ø2,20 mm. Milimetrada	●	●
OSTD28Z	Fresa quirúrgica. Ø2,80 mm. Milimetrada	●	●
OSTD35Z	Fresa quirúrgica. Ø3,50 mm. Milimetrada	●	●
OTD42Z	Fresa quirúrgica. Ø4,20 mm. Milimetrada	●	●
OTDZ1CA	Fresa cortical. Ø3,50 mm	●	●
OTDZ2CA	Fresa cortical. Ø4,10 mm	●	●
OTDZ3CA	Fresa cortical. Ø4,80 mm	●	●
CLD34	Fresa quirúrgica cristal. Ø4,10 mm		●
CLD50	Fresa quirúrgica cristal. Ø5,10 mm		●
PMT1G	Pin paralelizador. ZV2. RP. Manual. Titanio Grado 5 ELI		●
PMT2G	Pin paralelizador. ZV2. WP. Manual. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD106	Tope de fresa calibrado. ZV2. 3. H6 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD108	Tope de fresa calibrado. ZV2. 3. H8 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD110	Tope de fresa calibrado. ZV2. 3. H10 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD112	Tope de fresa calibrado. ZV2. 3. H12 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD114	Tope de fresa calibrado. ZV2. 3. H14 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD210	Tope de fresa calibrado. ZV2. 4. H10 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD212	Tope de fresa calibrado. ZV2. 4. H12 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTPD214	Tope de fresa calibrado. ZV2. 4. H14 mm. Titanio Grado 5 ELI		●
VTAP34M	Terraja quirúrgica. ZV2. RP. Ø3,40 mm. Milimetrada. CA/Manual	●	●
VTAP41M	Terraja quirúrgica. ZV2. RP. Ø4,10 mm. Milimetrada. CA/Manual	●	●
VTAP48M	Terraja quirúrgica. ZV2. WP. Ø4,80 mm. Milimetrada. CA/Manual	●	●
MUR100V2	Sonda/Paralelizador. Ø2,20 mm. Milimetrado. Titanio Grado 5 ELI		●
MUR200V2	Sonda/Paralelizador. Ø2,20/2,80 mm. Milimetrado. Titanio Grado 5 ELI		●
MUR300V2	Sonda/Paralelizador. Ø3,50 mm. Milimetrado. Titanio Grado 5 ELI		●
MUR400V2	Sonda/Paralelizador. Ø4,20 mm. Milimetrado. Titanio Grado 5 ELI		●
SMRGV	Llave inserción VPress. Milimetrada. Carraca	●	●
LMRGV	Llave inserción VPress. Larga. Milimetrada. Carraca	●	●
SMWGV	Llave inserción VPress. Corta. Milimetrada. Carraca	●	●
SMRGV1	Llave inserción VPress. Corta. Milimetrada. CA.	●	●
LMRGV1	Llave inserción VPress. Larga. Milimetrada. CA.	●	●
SMWGV1	Llave inserción VPress. Corta. Milimetrada. CA.	●	●
DEXT10	Prolongador de fresas	●	●
MESD	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. CA	●	●
LMSD	Destornillador quirúrgico. Ø1,25 mm. Largo. Manual	●	●
SMSD	Destornillador quirúrgico. Ø1,25 mm. Corto. Manual	●	●
TORK50	Carraca dinamoétrica regulable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm	●	●

FRESAS QUIRÚRGICAS

Fresa lanza



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,00	16,30	SID010



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Fresa piloto ZV2



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,20	16,50	OSPD22Z

Milimetrado: 6/8/10/12/14



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Fresa quirúrgica ZV2



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,80	16,50	OSTD28Z
	3,50	16,50	OSTD35Z
	4,20	16,50	OTD42Z

Milimetrado: 6/8/10/12/14 para fresas con diámetros de 2,80/3,50 mm

Milimetrado: 10/12/14 para fresa con diámetro de 4,20 mm



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Fresa cortical ZV2



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
	3,50	OTDZICA
	4,10	OTDZ2CA
	4,80	OTDZ3CA



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Fresa quirúrgica cresta



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
Universal	4,10	CLD34
	5,10	CLD50



PIN

Pin Paralelizador ZV2




Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	4,50	11,00	PMT1G
	5,50	11,00	PMT2G



TOPES

Tope de fresa calibrado ZV2



Fresa	Tipo	Longitud (L) Implante	Referencia
	3	6,00	VTPD106
		8,00	VTPD108
		10,00	VTPD110
		12,00	VTPD112
	4	14,00	VTPD114
		10,00	VTPD210
		12,00	VTPD212
14,00	VTPD214		
Pack *		--	KSTPV120

* Pack completo 8 topes calibrados



TERRAJAS

Terraja quirúrgica. CA. ZV2



Plataf.	Diámetro (Ø)	Referencia
	3,40	VTAP34M
	4,10	VTAP41M
	4,80	VTAP48M

Milimetrado: 6/8/10/12/14



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Instrumental quirúrgico

SONDAS

Sonda/Paralelizador ZV2



Plataf.	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Referencia
	2,20	26,00	MUR100V2
	2,80	27,00	MUR200V2
	3,50	26,00	MUR300V2
	4,20	26,00	MUR400V2

Milimetrado: 6/8/10/12/14



Para más información sobre el uso de instrumental quirúrgico consulte la sección "Protocolo quirúrgico simplificado" en la página 48 de este catálogo.

LLAVES

Llave de inserción VPress. Carraca



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	12,50/Corta	SMRGV
	19,50/Larga	LMRGV
	12,40/Corta	SMWGV
	19,40/Larga	LMWGV

● Doble hexágono / ■ Cuadrado 4x4 mm

Milimetrado: 1/2/3/4/5/6



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Llave de inserción VPress. CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	22,20/Corta	SMRGV1
	32,20/Larga	LMRGV1
	20,90/Corta	SMWGV1
	30,90/Larga	LMWGV1

● Doble hexágono

Milimetrado: 1/2/3/4/5/6



Instrumento con tratamiento superficial DLC.

Prolongador de fresas



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	12,00	DEXT10



DESTORNILLADORES

Destornillador quirúrgico. Manual



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	2,80/Mini	XSMSD *
	9,50/Corto	SMSD
	14,50/Largo	LMSD
	27,00/Extralargo	XLMSD *

● Hexagonal 1,25 mm



* Las Ref. XSMSD/XLMSD, NO están incluidas en la caja de cirugía.

Punta de destornillador. CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	20,00/Corta	MESD01 *
	25,00/Larga	MESD


● Hexagonal 1,25 mm



* La Ref. MESD01, NO esta incluida en la caja de cirugía.

CARRACAS

Carraca dinamoétrica regulable



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	86,80	TORK50


■ Cuadrado 4x4 mm



Instrumental complementario

ADAPTADORES

Prolongador para carraca




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	7,20	LAEX

■ Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de cirugía.

Adaptador de carraca a CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	7,20	MAEX

■ Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de cirugía.

KIT DE PRUEBA DE LABORATORIO

Kit prueba de laboratorio



Plataf.	Altura (H)	Referencia
	4,00	GLAB40
	4,00	GLAB50




Este producto no sustituye el control de la planificación del caso clínico.

NO incluido en la caja de cirugía.

PLANTILLA RADIOGRÁFICA

Plantilla radiográfica ZV2



Plataf.	Modelo	Referencia
	ZV2	PRADIO150

Escalas 1:1 y 1:1,25

Material: acetato transparente. Elemento no esterilizable.

Consulte la bibliografía disponible en www.ziacom.com/biblioteca






ZVZ

Instrumental protésico



Instrumental protésico

Caja de prótesis



■ Composiciones disponibles cajas protésicas

Contenido	Referencia
Vacía	BOXPN
Básica	BOXPSN
Completa	BOXPCN

134°
SSS

Material: radel.

Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.

■ Contenido de las cajas protésicas


REF	Descripción	BOXPSN	BOXPCN
LOSD01	Llave de inserción Kirator. Carraca	●	●
MABA100	Llave de inserción Basic. Corta. Carraca. Titanio Grado 5 ELI	●	●
MABA200	Llave de inserción XDrive. Corta. Carraca. Titanio Grado 5 ELI	●	●
MADW10	Puño destornillador. 4x4. Manual	●	●
SMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Corta. Carraca	●	●
LMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Larga. Carraca	●	●
XLMSD1	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Extralarga. Carraca		●
MESD	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Larga. CA.	●	●
MESD01	Punta de destornillador. Ø1,25 mm. Corta. CA.	●	●
MESD1TX	Punta de destornillador Tx30. Larga. CA	●	●
LMSD1TX	Punta de destornillador Tx30. Larga. Carraca	●	●
EDSZ20 *	Tornillo extractor ZPlus. Zinc®. NP. Titanio Grado 5 ELI		●
EDSZ34 *	Tornillo extractor ZPlus. Zinc®. RP/WP. Titanio Grado 5 ELI		●
EDSG34	Tornillo extractor pilares. Galaxy/ZV2. RP. Titanio Grado 5 ELI		●
EDSG50 *	Tornillo extractor pilares. ZV2. WP. Titanio Grado 5 ELI		●
TORK50	Carraca dinamoétrica regulable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm	●	●

* Producto no incluido en el sistema ZV2.



LLAVES

Llave de inserción Kirator



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Kirator	13,60/Carraca/Manual	LOSD01
	20,00/CA	LOSD02*

◆ Cuadrado 2,11 mm / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. LOSD02 NO está incluida en la caja de prótesis.

Llave de inserción Basic. Carraca




Sistema	Longitud (L)	Referencia
Basic	5,00/Corta	MABA100
	13,00/Larga	MABA110*

◆ Basic / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. MABA110 NO está incluida en la caja de prótesis.

Llave de inserción XDrive. Carraca



Sistema	Longitud (L)	Referencia
XDrive	6,00/Corta	MABA200
	13,00/Larga	MABA210*


○ XDrive / ■ Cuadrado 4x4 mm



* La Ref. MABA210 NO está incluida en la caja de prótesis.

DESTORNILLADORES

Puño destornillador




Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	12,90	MADW10

■ Cuadrado 4x4 mm



Punta de destornillador. Carraca



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	9,50/Corta	SMSD1
	14,50/Larga	LMSD1
	27,00/Extralarga	XLMSD1

■ Cuadrado 4x4 mm



Punta de destornillador. CA



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	20,00/Corta	MESD01
	25,00/Larga	MESD



Punta de destornillador Tx30. CA



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Tx30	26,00/Corta	MESD01TX *
	32,00/Larga	MESDTX



No exceder de 30 Ncm, ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* La Ref. MESD01TX NO está incluida en la caja de prótesis.

Punta de destornillador Tx30. Carraca



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Tx30	12,00/Corta	SMSD1TX *
	18,00/Larga	LMSD1TX

■ Cuadrado 4x4 mm



No exceder de 30 Ncm, ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* La Ref. SMSD1TX NO está incluida en la caja de prótesis.

Destornillador protésico Tx30. Manual



Sistema	Longitud (L)	Referencia
Tx30	12,00/Corta	SMSD1TX *
	18,00/Larga	LMSD1TX *



No exceder de 30 Ncm, ya que puede ocasionar graves daños al destornillador y al tornillo.

* Las Ref. SMSD1TX/LMSD1TX NO están incluidas en la caja de prótesis.

Instrumental protésico

TORNILLO EXTRACTOR

Tornillo extractor ZPlus



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	25,00	EDSZ20 *
	23,70	EDSZ34 *

Anodizado NP RP/WP



Tornillo extractor pilares Galaxy/ZV2



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
	25,00	EDSG34 *
	26,80	EDSG50 *

Anodizado RP WP



* Producto no incluido en el sistema ZV2.

CARRACAS

Carraca dinamo métrica regulable



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	86,80	TORK50

Cuadrado 4x4 mm



Instrumental complementario

Adaptador de CA a carraca



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Universal	12,00	MC10Z

Cuadrado 4x4 mm



NO incluido en la caja de prótesis.

Puño insertador retenciones + Extractor



Plataf.	A Longitud (L)	B Longitud (L)	Referencia
Kirator	81,50	110,40	MBEI3610
ZM-Equator			



NO incluido en la caja de prótesis.

Insertador de retenciones



Plataf.	Longitud (L)	Referencia
Kirator	32,00	MBEI3602
ZM-Equator	32,00	MBEI3603



Insertadores para cofias plásticas Kirator / ZM-Equator.
NO incluido en la caja de prótesis.

Juntas retentivas instrumental



Plataf.	Medida	Referencia
Universal	2x1	RREI0030

Pack de 10 unidades.

Protocolo
quirúrgico
simplificado




Protocolo quirúrgico simplificado

Características del sistema de fresado ZV2


■ Sistema de fresas Ziacom® - Superficie DLC

Las fresas de los sistemas de implantes Ziacom® están fabricadas en acero inoxidable recubierto por un tratamiento superficial DLC (Diamond Like Carbon), que les confiere mayor resistencia a la corrosión durante la esterilización, un bajo coeficiente de fricción y resistencia al desgaste, lo que aumenta la longevidad del filo de las mismas. Por otra parte, la superficie es mate, lo que le otorga una propiedad anti reflejo. El marcado láser en el vástago de las fresas identifica su diámetro mayor y menor y su longitud, y la banda horizontal del marcado láser en su parte activa representa las diferentes longitudes de los implantes (fresas milimetradas). La longitud de la punta de la fresa es de 0,5 mm y no está incluida en las mediciones de las diferentes marcas laser.




■ Terrajas Ziacom® - Superficie DLC

Se encuentran disponibles terrajas para contra ángulo. El marcado láser en el vástago de las terrajas identifica su diámetro y la banda horizontal del marcado láser en su parte activa representa las diferentes longitudes.



■ Sonda

Compruebe la profundidad del lecho quirúrgico, especialmente si no se emplean topes de fresa. Para verificar el eje del lecho quirúrgico, los paralelizadores disponen de diámetros diferenciados según la secuencia de fresado.




■ Llaves de inserción VPress

La llave de inserción VPress para contraángulo o para carraca, ha sido especialmente diseñada para transportar el implante ZV2 desde su vial No Mount hasta el lecho quirúrgico para su inserción.

Llaves de inserción cortas y largas para carraca y contra-ángulo




Marcado de profundidad a la plataforma del implante en los instrumentos de inserción



Protocolo de fresado - Ziacom® No Mount

Rotación
 Requiere irrigación
 Diámetro fresa
 Torque

Las velocidades detalladas son las recomendadas

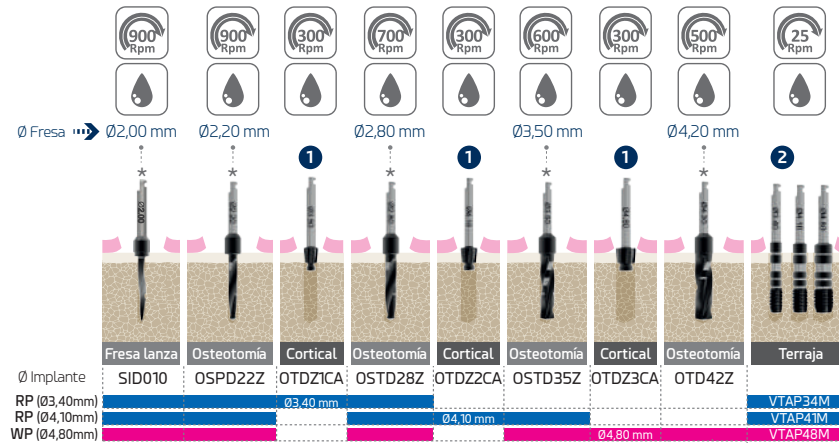

*Para fresado en hueso Tipo I/Tipo II aumente 200 Rpm con respecto a las indicadas en el gráfico superior.

1 Uso de la fresa cortical

Según diámetro de implante y tipo de hueso:

	Diámetro implante		
Tipo de hueso	Ø3,30 mm	Ø4,10 mm	Ø4,80 mm
Tipo I	Obligatorio*	Obligatorio*	Obligatorio*
Tipo II	Obligatorio*	Obligatorio*	Obligatorio*
Tipo III - IV	Obligatorio*	Obligatorio*	Obligatorio*

* No se recomienda usar la fresa cortical en elevaciones de seno maxilar.

2 Uso de la terraja

Según diámetro de implante y tipo de hueso:

	Diámetro implante		
Tipo de hueso	Ø3,30 mm	Ø4,10 mm	Ø4,80 mm
Tipo I	Total	Total	Total
Tipo II	Total	Total	Total
Tipo III - IV	No necesario	Total	Total

Protocolo quirúrgico simplificado

Inserción del implante - Ziacom® No Mount

■ Sobre Ziacom® No Mount

Los implantes Ziacom® están disponibles sin transportador. Este formato del blíster permite a los implantólogos retirar cómodamente el implante del vial y colocarlo en el lecho quirúrgico con un instrumento directo en un solo paso, ahorrando tiempo en la intervención. El implante sin transportador facilita la instrumentación en espacios reducidos y permite una mejor visibilidad del campo de trabajo.

Las llaves de inserción directa a implante disponen, en su parte de sujeción, de un centrador para evitar dañar la conexión y de una arandela en su extremo activo que proporcionan una función rápida y segura de transportar el implante a su lecho quirúrgico.



Paso 1: conexión llave de inserción VPress




Paso 2A: posición final del implante con CA



Paso 2B: posición final del implante con carraca



■ Inserción directa



Inserción


■ SMRGV / LMRGV
■ SMRGV1 / LMRGV1

■ SMWGV / LMWGV
■ SMWGV1 / LMWGV1

■ Colocación crestral del implante

La plataforma de los implantes Ziacom® debe colocarse al nivel de la cresta ósea.

Posición crestral
RECOMENDADA



■ Tipos de hueso

Clasificación de Lekholm y Zarb (1985)



HUESO TIPO IV - HUESO BLANDO

- Cortical delgada que rodea el hueso esponjoso, poco denso.



HUESO TIPO II y III - HUESO MEDIO

- Tipo II: hueso compacto ancho rodea el hueso esponjoso denso.
- Tipo III: la cortical delgada rodea el hueso esponjoso denso.



HUESO TIPO I - HUESO DURO

- Se compone casi exclusivamente de hueso compacto homogéneo.

Recomendaciones generales

A tener en cuenta durante la intervención



Las fresas quirúrgicas deben insertarse en el contra ángulo con el motor quirúrgico parado, asegurando el correcto anclaje y rotación antes de comenzar el fresado. Trate las fresas con sumo cuidado: el más mínimo daño en las puntas puede comprometer su eficacia.



Cada instrumento debe ser empleado solamente para el uso específico recomendado por el fabricante.




Los instrumentos dañados deben ser eliminados según la normativa local.




El implantólogo debe guardar en la ficha del paciente una de las etiquetas identificativas suministradas con el producto para su correcta trazabilidad.

Manipulación del tornillo de cierre



Retire de su vial el tornillo de cierre con el atornillador hexagonal, en sentido contrario a las agujas del reloj. Aproxímelo al implante evitando la caída e ingestión accidental del tornillo. Insértelo en el implante hasta su cierre, con torque manual y en sentido de las agujas del reloj.

Preparación para segunda fase quirúrgica



Colocación del pilar de cicatrización

El pilar de cicatrización debe corresponder con la plataforma del implante, valorando la opción de aplicar la técnica de platform switch con pilares anatómicos y estar en concordancia con la altura del tejido gingival para evitar la oclusión del pilar. Una altura excesiva podría someter al implante a cargas prematuras, comprometiendo así el proceso de osteointegración.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Sobre la inserción del implante

Una compresión excesiva en el hueso receptor puede provocar la no osteointegración del implante.

No seguir los pasos descritos en la secuencia quirúrgica puede provocar:

- Falta de estabilidad primaria por pérdida del hueso de soporte.
- Dificultades en la inserción del implante.

Sobrepasar el torque (50 Ncm) en la inserción del implante puede producir:

- Deformaciones irreversibles en la conexión interna/externa.
- Deformaciones irreversibles en el instrumental indicado para la inserción del implante.
- Dificultades de desmontaje del conjunto instrumento/implante.

Torque máximo de inserción y velocidad

El torque recomendado de inserción se encuentra entre los 35 y 50 Ncm según cada caso sin limitarse a un torque único.



La inserción del implante debe realizarse, en función de la densidad y calidad ósea del lecho receptor, con torque controlado:

Instrumental de inserción o destornilladores en CA: use velocidad máxima de:



Implantes ZV2

El protocolo quirúrgico Ziacom® establece la posición crestral de la plataforma del implante.

Para evitar estrés cortical y deformación de llave y/o conexión del implante, así como gripado del Mount, la inserción con contra ángulo (CA) debe respetar las rpm máximas recomendadas (25 Rpm) y el torque máximo indicado (50 Ncm).

En el uso de carraca no dinamométrica se requiere vigilar la resistencia durante la inserción. En caso de producirse, para liberar al hueso de las tensiones provocadas y facilitar el labrado de la espira, se recomienda extraer el implante con dos vueltas y, tras segundos de pausa, seguir con la inserción y repetir este proceso cuantas veces sea necesario.

Consulte siempre los protocolos quirúrgicos y protésicos publicados en el presente catálogo, así como el resto de documentos disponibles en la sección 'Biblioteca' de nuestra web www.ziacom.com/biblioteca que hacen referencia a procedimientos, protocolos e instrucciones de uso antes de utilizar el sistema ZV2 de Ziacom®.





ZVZ

Limpieza, desinfección y esterilización



Limpieza, desinfección y esterilización

Los protocolos que se describen a continuación deben ser llevados a cabo únicamente por personal cualificado para la limpieza, desinfección y esterilización del material dental aquí especificado.

Instrucciones de limpieza y desinfección

Aplicable para instrumental, cajas quirúrgicas y protésicas y cofias plásticas retentivas.

■ Desmontaje

1. Desmonte* el instrumental que así lo requiera, como por ejemplo las carracas manuales, las fresas o los topes de fresa.
2. Desmonte la caja quirúrgica o protésica en sus diferentes componentes para una correcta limpieza.

■ Limpieza y desinfección

Para la desinfección del instrumental y las cajas quirúrgicas:

1. Sumerja el instrumental en una solución de detergente-desinfectante** indicado para instrumental dental para facilitar la eliminación de los restos biológicos adheridos. Si dispone de equipo de ultrasonidos***, compruebe que el detergente-desinfectante esté indicado para su uso con dicho equipo.
2. Retire manualmente los restos biológicos con un cepillo no metálico y detergente de pH neutro.
3. Aclare con abundante agua.
4. Para la limpieza de las cajas quirúrgicas y protésicas utilice siempre detergentes de pH neutro y utensilios no abrasivos para no dañar las superficies de las cajas.
5. Seque el material con celulosa desechable, paños que no dejen fibras o aire comprimido.

Para la desinfección de las cofias plásticas y el disco protector:

1. Sumerja durante 10 minutos en una solución de cloruro de benzalconio puro.
2. Aclare con agua destilada.
3. Seque las cofias y el disco antes de su utilización.

■ Inspección

1. Compruebe que el instrumental está perfectamente limpio, de lo contrario, repita los pasos de limpieza y desinfección.
2. Descarte el instrumental que muestre desperfectos y sustitúyalo para la siguiente cirugía.
3. Verifique que el instrumental y las cajas quirúrgicas y protésicas están perfectamente secas antes de realizar su montaje y proceder a la esterilización.

* Consulte los manuales de montaje y desmontaje en www.ziacom.com/biblioteca

** Siga las instrucciones del fabricante del producto desinfectante para determinar las concentraciones y tiempos.

*** Siga las instrucciones del fabricante del equipo de ultrasonidos para determinar la temperatura, concentración y tiempos.

Instrucciones de esterilización en autoclave de vapor

Aplicable para implantes de ortodoncia, aditamentos, instrumental y cajas quirúrgicas y protésicas.

1. Introduzca el material de forma individual en bolsas de esterilización y a continuación selle las bolsas. Para una esterilización conjunta, coloque el instrumental en su caja quirúrgica, introduzca la caja en una bolsa de esterilización y selle la bolsa.
2. Introduzca las bolsas a esterilizar en el autoclave.
3. Esterilice en autoclave de vapor a 134°C/273°F (máx. 137°C/276°F) durante 4 min (mínimo) y 2 atm de presión. Las carracas dinamométricas se deben esterilizar en 3 ciclos de vacío a 132°C/270°F durante al menos 1,5 minutos y secar al vacío durante al menos 20 minutos.

Sólo para Estados Unidos: El ciclo de esterilización validado y recomendado en EE.UU debe ser realizado en autoclave de vapor, a 132°C/270°F, durante un tiempo mínimo de 15 minutos y con tiempo de secado de al menos de 15-30 minutos.

IMPORTANTE

Asegúrese de que se completa la fase de secado establecida para evitar que los productos salgan húmedos.

Revise el equipo de esterilización si el material o las bolsas de esterilización presentan humedad al finalizar la esterilización.

Realice el mantenimiento del autoclave con la periodicidad establecida y las acciones necesarias, siguiendo las instrucciones del fabricante.



Conservación de los productos Ziacom®


- Mantenga los productos en sus envases originales y en un ambiente seco y limpio hasta su uso.
- Tras su esterilización conserve los productos en las bolsas de esterilización selladas y en un ambiente seco y limpio.
- Nunca sobrepase las fechas de caducidad determinadas por el fabricante de las bolsas de esterilización.
- Siga siempre las indicaciones del fabricante de las bolsas de esterilización.

Recomendaciones generales

- Nunca utilice material dañado o sucio ni reutilice productos indicados para un solo uso. El usuario es el responsable del correcto seguimiento de las instrucciones descritas en este documento.
- Preste atención a los elementos punzantes y cortantes. Se recomienda el uso de guantes durante la limpieza del material para evitar accidentes durante la manipulación.
- Siga las indicaciones de seguridad indicadas por el fabricante del agente desinfectante.
- La esterilidad no se puede garantizar si la bolsa de esterilización está abierta, dañada o mojada.
- Respete todas las fases del esterilizador. En caso de que el material o las bolsas de esterilización presenten restos de agua o humedad, revise el autoclave y repita la esterilización.
- Los aditamentos y los implantes de ortodoncia se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser siempre esterilizados previamente a su uso.
- El instrumental, las cajas quirúrgicas y protésicas se suministran SIN ESTERILIZAR y deben ser siempre esterilizados previamente a su uso y limpiarse y desinfectarse con posterioridad.
- Los procesos de esterilización, limpieza y desinfección deterioran progresivamente el instrumental. Inspeccione el instrumental minuciosamente para detectar signos de deterioro.
- Evite que los productos de diferentes materiales (acero, titanio...) entren en contacto durante los procesos de limpieza, desinfección y esterilización.
- Para el correcto mantenimiento y seguridad de sus productos, Ziacom Medical SL recomienda seguir estas instrucciones y por lo tanto la empresa no se hace responsable de la afectación que el empleo de procedimientos alternativos de limpieza, desinfección y esterilización por parte del usuario puedan tener en los productos.

Consulte la última versión de las instrucciones de limpieza, desinfección y esterilización en www.ziacom.com/biblioteca





Consulte las condiciones generales de venta actualizadas en nuestra página web www.ziacom.com

Consulte la disponibilidad de cada producto por país.

Quedan reservados todos los derechos. No se puede reproducir ninguna parte de esta documentación, ni almacenar en ningún medio o sistema de reproducción, ni transmitir de forma alguna, ni bajo ningún concepto, electrónicamente, mecánicamente, en fotocopias, en grabación ni de ninguna otra manera no contemplada aquí sin el permiso del propietario de los derechos de la marca, edición e impresión. Ziacom® es un marca registrada de Ziacom Medical SL.

Consulte la última versión disponible de los catálogos en www.ziacom.com.

ES | ESPAÑOL



www.ziacom.com

Ziacom Medical SL

Calle Búhos, 2
28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA
Tfno.: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1 (786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com